

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 10.09.2020 r.

ZP/ 51/2020

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy: Zał_nr_2_Formularz_asortymentowo_cenowy: Pakiet 1. Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych, poz. 4:

Z uwagi na wymaganą kompatybilność worków z roztworem cytrynianu do oferowanych zestawów prosimy o dopuszczenie worków z nowymi, bezpieczniejszymi portami do pobierania płynu typu SecuNect oraz nie zawierającymi dodatkowych portów z membraną do nakłucia igłą – modyfikacja składu roztworu do antykoagulacji cytrynianowej jest przeciwwskazana.

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy: Zał_nr_2_Formularz_asortymentowo_cenowy: Pakiet 1. Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych, poz. 7:

Hemofiltraty z wymaganym wysokim punktem odcięcia (min. 40 kD) nie powinny być stosowane w zabiegach nerkozastępczych opartych na konwekcji (hemofiltracja, hemodiafiltracja) z racji ryzyka eliminacji albumin z krwi pacjenta, dlatego prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w tej pozycji jedynie zestawów do hemodializy cytrynianowej z wymaganym hemofiltrem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



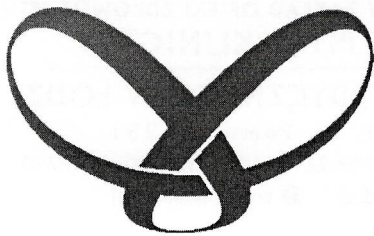

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 3

PAKIET NR 11

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran o następującym składzie:
 - a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku
 - b. 2 x opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.
 - c. 1 x samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8 x 8 cm połączona z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
 - d. 6 x samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa w rozmiarze 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 4

PAKIET NR 11

2. **Poz. nr 2-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę z filtrami powietrznym i węglowym, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączonego z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm, o pojemności 800 ml z odpowiednim przeliczeniem pojemności na ilość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 8

1. Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet 8 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: dla pozycji 2 - 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54

dla pozycji 2 – 55/76 cm?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



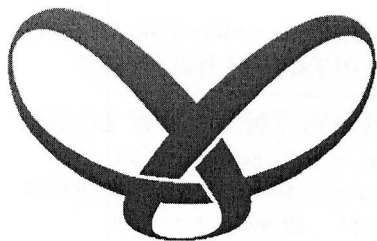

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu.

Pytanie nr 7

Pakiet 2.1

Czy Zamawiający dopuści łączniki Y w rozmiarach:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



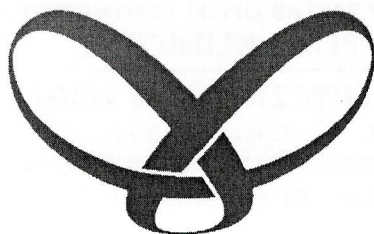

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łącznik -		
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]
1	7	5
2	9	6
3	11	9
4	13	10
5	16	13
6	18	15

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 2.1 i 2.4

Czy Zamawiający dopuści łączniki proste w rozmiarach:

Łącznik prosty		
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]
1	6	5
2	8	6
3	10	9
4	12	10

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 2.3


Czy Zamawiający dopuści łączniki proste z kontrolą siły ssania w rozmiarze:



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



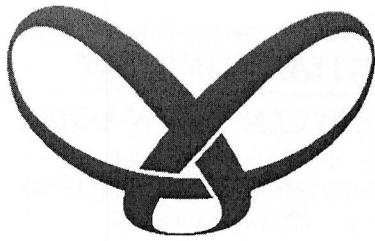

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łącznik z kontrolą siły ssania			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylny	niesterylny
10	6	9F-0610	9F-0600

 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 3.1

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 1 do 5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 6 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika implantowanego fenestrowanego do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 425 mm, długość fenestrowana 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 6 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika implantowanego fenestrowanego do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 500 mm, długość fenestrowana 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 6 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”




PN-EN ISO 14001

ISOCERT CERTYFIKAT

PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

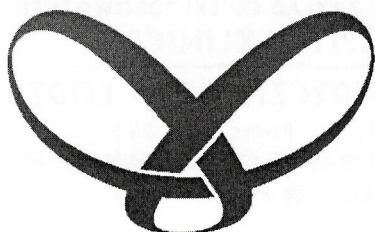

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

implantowanego fenestrowanego do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 575 mm, długość fenestrowana 225 mm.

Odpowiedź:

zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 6 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedynczo. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; możliwa prędkość przepływu 5, 7, 12 ml/h, nominalny czas pracy odpowiednio 48-34-20h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 6 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego przenośny, jałowy, apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



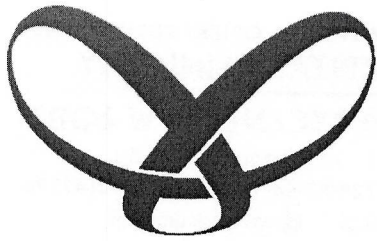

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedynczo. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; możliwe prędkość przepływu 2, 4, 6 ml/h, nominalny czas pracy odpowiednio 120-60-40h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Zmawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu poz 1,2,3.

Pytanie nr 16

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 6 w pozycji 4,5 podania leku w systemie zamkniętym (czyli bez filtrów na przebiegu linii) – jedynym bezpiecznym zarówno dla pacjenta i personelu. Norma ISO 28620 dotycząca przenośnych urządzeń infuzyjnych podkreśla, że wszystkie elementy urządzenia przeznaczone do kontaktu z lekiem stanowią zamknięty, wodoszczelny system. Jedynie system zamknięty (bez filtrów na linii) uniemożliwia wnikanie drobnoustrojów i zapobiega potencjalnym wyciekom leku. Czy biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zamawiający wymaga: przenośnego, jałowego, apirogennego system infuzyjnego wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Dopuszcza system z filtrem na przebiegu linii infuzyjnej wbudowany w linię.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 8 w pozycji 1 cewnik permanenty firmy Teleflex Medical wg. następującego opisu :

Cewnik 15Fr długości 19cm, 23cm ,27cm ,31cm, 42cm, 55cm

Elementy sterylnego zestawu wprowadzającego:

1 szt. Prowadnik druciany 120cm z powłoką PTFE o przekroju: .038" (.97 mm) z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła. Zestaw wprowadzający ArrowAdvancer z nakładką zabezpieczającą

1 szt. SmartSeal® rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną i rozszerzadłem: 16 Fr/13cm



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



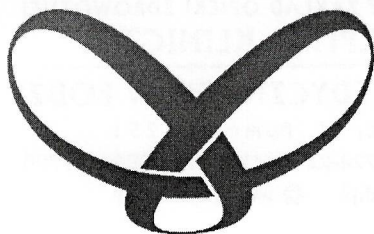

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- 1 szt. cienkościenna igła punkcyjna 6,35cm/18Ga x 21/2" XTW
- 1 szt. tunelizator metalowy
- 2 szt. korki Luer-Lock
- 1 szt. opatrunek Tegaderm® 10 cm x 12 cm
- 1 szt. SharpsAway II™ kubek z blokadą na igły
- 1 szt. bezpieczny skalpel rozmiar 11
- 1 szt. karta identyfikacyjna pacjenta
- 1 szt. rozszerzadło 12 Fr
- 1 szt. rozszerzadło 14 Fr

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie 3 pozycję 2 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Pakiet 6 poz. 1-3:

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1-3 z pakietu, co pozwoli na złożenie oferty co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Pakiet 6 poz. 1-3:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do infiltracji ran, w zestawie: cewnik do infiltracji ran 18G z 30 otworami na pierwszych 15 cm lub z 60 otworami na pierwszych 30 cm, długość cewnika 100 cm, widoczny w RTG; strzykawką 5 ml, filtr 0,2 mikrona, opatrunek mocujący cewnik, rozrywalna igła wprowadzająca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 6 poz. 4:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego przenośnego systemu infuzyjnego, wolnego od DEHP i lateksu, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml, w wygodnej obudowie w kształcie płaskiego dysku, dozujący lek ze stałą prędkością



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



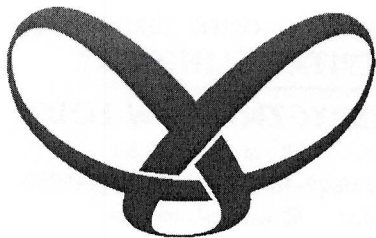

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

przepływu 5 ml/h, 8 ml/h lub 10 ml/h. Pompa wyposażona w filtr cząsteczkowy 5 mikrona na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia w centralnej części obudowy, osłonięty kapturkiem Luer Lock. System sprawdzony pod względem stabilności z m.in. bupiwakainą, ropiwokainą. Urządzenie pakowane pojedynczo, aseptyczne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowalnym filtrem automatycznie usuwający powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie nr 22

Pakiet 6 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego, przenośnego systemu infuzyjnego, w całości wolnego od DEHP i lateksu, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml, w wygodnej obudowie w kształcie płaskiego dysku, z możliwością regulacji prędkości w zakresie 1- 14 ml/godz. Pompa wyposażona w filtr cząsteczkowy 5 mikrona na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia w centralnej części obudowy, osłonięty kapturkiem Luer Lock. System sprawdzony pod względem stabilności z m.in. bupiwakainą, ropiwokainą. Urządzenie pakowane pojedynczo, aseptyczne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowalnym filtrem automatycznie usuwający powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ.

Uwaga:

W przypadku dopuszczenia innych parametrów niż określone w SIWZ, należy wpisać w Załączniku nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe) oferowany parametr oraz dopisać, że został on dopuszczony zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

[Signature]
mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechostowicka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



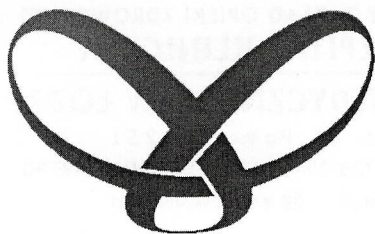

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

