

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 20.07.2018 r.

ZP/46 /2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 poz.1579 t.j.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 12-22 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 12-22 kg. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek dla dorosłych bez ściągaczy taliowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 60-85 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 60-85 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 70-110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 70-110 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 110-170 cm?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



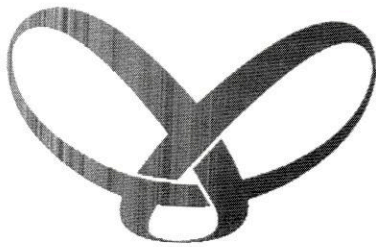

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie pasa 110-170 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 3, po. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek higienicznych w opakowaniach po 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkładek higienicznych w opakowaniach po 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozm. M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spodenek w rozm. M/L oraz XL/XXL. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 1.500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 1.500 ml. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego TPE (termoplastyczny elastomer poliestrowy)?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne wykonane z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, bez paska na piętę? Obuwie jest bardzo trwałe, dostępne w kolorze zielonym, granatowym i fioletowym, podlegające praniu i dezynfekcji, bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający dopuści obuwie bez paska antystatycznego w podeszwie?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



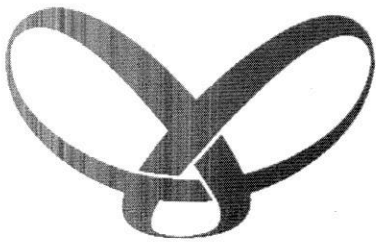

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający wymaga obuwia z oznaczeniem rozmiaru na pięcie?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w rozmiarach 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14

Pakiet 11 - Dostawa obuwia operacyjnego:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ENV 13288?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15

w Pakiecie 7 poz. 2 oraz 3

Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr. o właściwościach ochronnych, zabezpieczający skórę przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń oraz odleżyn, tworzący na skórze warstwę ochronną – zabezpieczając skórę przed szkodliwym działaniem czynników drażniących zawartych w. im w kale i moczu. Tlenek cynku oraz odpowiednio dobrane składniki aktywne tworzą kompleks pochłaniający zapach moczu. Krem konfekcjonowany w pojemnikach plastikowych z zabezpieczeniem, o masie 250 g odpowiadającej 200 ml.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 oraz 3 z Pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie poz. 2 i 3 zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie, jednocześnie bardzo wyraźnie wskazując, który to podmiot.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny SMMS gr. min 35g/m2 Nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie "V" zakończone białą lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cm H₂O. Dostępne w 3 kolorach: niebieskim, różowym, zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



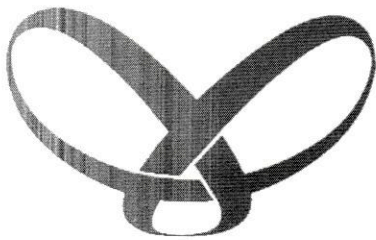

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 18

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS o gramaturze min. 35g/m²?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ

Pytanie 19

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w jednym z kolorów : niebieskim lub zielonym?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 8 poz. 1

Czy obszycie przy szyi może być wykonane z białej lamówki?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet zakończony dzianym mankietem?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę bez wszytego rękawa?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



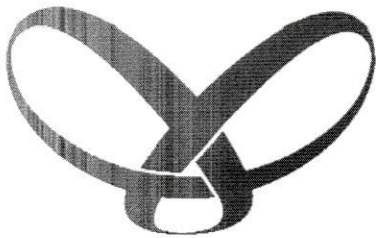

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszuli bez wszytego rękawa. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę bez lamówki? Troki doszyte z tyłu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszuli bez lamówki, troki doszyte z tyłu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści klapki z podeszwą z pianki lub filcu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kłapek z podeszwą z pianki lub filcu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 12 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na perforację co 38cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rolkę podfoliowaną 50cm x 50mb, perforowane co 38cm, gramatura podkładu 29g/m², folia PE 6g/m². Każda rolka zabezpieczona folią?

Oferujemy przeliczenie ilości z 3600 rolek a'65mb na 4680 rolek a'50mb z podziałem na CDK - 3250 rolek a'50mb (z 2500 rolek a'65mb), CSK – 455 rolek a'50mb (z 350 rolek a'65mb), SPOR. – 975 rolek a'50mb (z 750 rolek a'65mb).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 30

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę włókniny min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 31

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar nieznacznie różniący się od wymaganego:

Poszwa : 210cm x 160cm

Poszewka : 70cm x 80cm

Prześcieradło 210cm x 160 cm ?



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



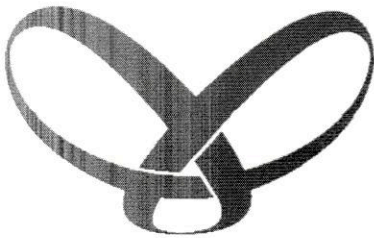

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w rozmiarów pościeli jednorazowej. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 14 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający oczekuje dwóch kolorów? Czy wyrobów w jednym z kolorów : niebieskim lub zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowują, iż oczekuje pościeli w jednym z wymienionych kolorów.

Pytanie 33

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, niejałowe podkłady włókninowe, wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 60 g/m², antyelektrostatycznej?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160cm x 90cm lub 150cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba w/w rozmiary. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200 x 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kompletu pościeli o następujących parametrach :

-wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²

-wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 32N

-wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 43N

-chłonność minimalna 200%

-komplet pościeli nadaje się do sterylizacji parą wodną

-rozmiar : powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm zgodnie z opisem z postępowania (sprawa nr ZP/25/2016).

Naszą prośbę uzasadniamy faktem, że Zamawiający użytkował komplety pościeli dostarczane przez naszą firmę i nie było co do nich żadnych negatywnych uwag.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”



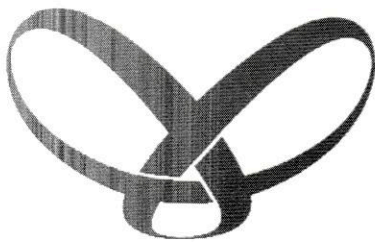

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 37

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m², w kolorze zielonym, posiadające wycięcie „V” zakończone białą lamówką?

Prosimy o odstąpienie wymogu odporności przenikania cieczy, gdyż norma EN 13795 w zakresie dotyczącym ubrań chirurgicznych (tabela nr 3) nie określa takiego wymogu.

Tablica 3 – Właściwości, które należy ocenić i wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych

Właściwość	Metoda badań (powołania normatywne, patrz Rozdział 2)	Jednostka	Wymaganie ²
Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho	EN ISO 22812	CFU	≤ 300 ²
Czystość – mikrobiologiczna	EN ISO 11737-1	CFU/ 100 cm ²	≤ 300
Czystość – pod względem cząstek stałych	EN ISO 9073-10	IPM	≤ 3,5
Pylenie	EN ISO 9073-10	log ₁₀ (liczba cząstek)	≤ 4,0
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho	EN ISO 13938-1	kPa	≥ 40
Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho	EN 29073-3	N	≥ 20

* Warunki badania: koncentracja przetrwalników bakterii wynosi 10⁸ CFU/g talku, czas działania wibracji wynosi 30 min.
² Wymagania użytkowe dotyczą wszystkich wyrobów z zakresu odzieży dla bloków operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu i dopuszcza ubrania nie posiadające badań na przenikanie cieczy.

Pytanie 38

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gram 21 g/m², dostępny w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 39

Pakiet 9, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych ściereczek w zamian gąbek, nasączonych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydydy służących do antyseptyki skóry przed zabiegami operacyjnymi, skuteczne w zakresie zmniejszania częstości zakażeń szpitalnych, w składzie m.in. diglukonian chlorheksydydy, PPG-20 dimeticone, bez lateksu, nie wymagający splukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiar 33cm x 23cm, pakowane po 4 sztuki z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania opakowania, wyrób posiadający stawkę VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



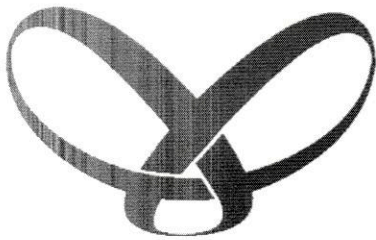

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 40

Pakiet 9, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego myjkę do mycia ciała pacjenta, nasączoną mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotową do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniaco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt. Rękawica dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. SKŁAD - wykonana z dwóch warstw - przednia: podkłady watinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5 - tylna: podkłady watinowe - wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm - wykonana z włókniny 100g/m, opakowanie 20 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 41

Pakiet 9, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta w składzie m.in. dimetikon, chlorheksydyna, witamina E, prowitamina B5, wyciąg z aloesu, składniki zapobiegające powstaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni, flory Gram dodatniej i Gram ujemnej, nie wymaga dodatkowego namaczania głowy oraz spłukiwania, opakowanie z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sek. Przy mocy 700W, wyrób posiadający stawkę VAT 23%?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 9, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego myjkę do mycia ciała pacjenta, w formie rękawicy nie wymagającej spłukiwania oraz namaczania z możliwością podgrzania myjki w mikrofalówce 700W (20 sekund) dla lepszego komfortu pacjenta. Rękawica dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. SKŁAD m.in. środek myjący o neutralnym pH 5,5, witamina E, Dimethicone Prowitamina B, D-Pentahanoole, wymiary: 23cm x14 cm (+/- 0,5 cm), , opakowanie 10 sztuk z możliwością wielokrotnego otwarcia, które zapobiega przed wyschnięciem, z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, wyrób posiadający stawkę VAT 23%?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 9, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 75x125 cm?

Odpowiedź:




ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



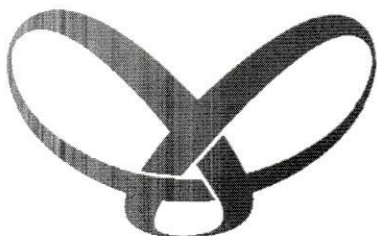

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha foliowego w rozmiarze 75x125 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 1 Poz 1.

Czy można zaoferować pieluchomajtki dla wcześniaków o wadze 600-1200g i chłonności minimalnej 60ml? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla wcześniaków o wadze 600-1200g i chłonności minimalnej 60ml. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 1 Poz2.

Czy można zaoferować pieluchomajtki dla wcześniaków o wadze do 2kg? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla wcześniaków o wadze do 2kg. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 5 Poz 1; 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji i zaoferowanie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku wykonanego z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 45g/m² zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho 138 kPa(badanie wg EN ISO 13938-1) Czystość pod względem cząstek stałych równa 2,7 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10) pylenie równe 2,8 Log10(liczba cząstek)(badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wycięcie typu serek, trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem bez kieszeni bocznej na nogawicy. Bluza i spodnie pakowane razem, dostępne w rozmiarach XS-XXXL w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Ubrania pakowane jako komplet (bluza + spodnie) z podaniem ceny za komplet w ilości zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 47

Pakiet 8 Poz. 1

Czy można zaoferować ubranie z włókniny o gramaturze 45 g, o odporności na przenikanie cieczy 23 cm H₂O, dostępne w kolorze niebieskim i zielonym, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 8 Poz 2.

Czy można zaoferować fartuch wizytacyjny, niejałowy wykonany z włókniny 17 g/m² w rozmiarze uniwersalnym?



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



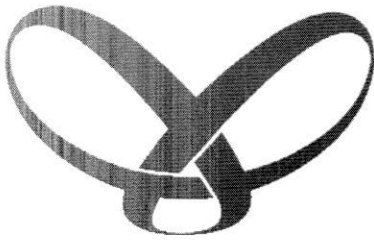

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 49

Pakiet 14 Poz 1.

Czy można zaoferować jednorazowy trzyczęściowy komplet bielizny pościelowej o rozmiarze poszwy 150x200cm, poszewki 75x90cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 50

Pakiet 14 Poz 2.

Czy można zaoferować jednorazową poszwę o wymiarach 150x200cm, opakowanie A'5 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51

Pakiet 14 Poz 3.

Czy można zaoferować jednorazowe prześcieradło higieniczne w opakowaniu A'20 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 52

Pakiet 14 Poz 4.

Czy można zaoferować jednorazową poszewkę o rozmiarze 90x75cm, opakowanie A'5 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 17 Poz 1.

Czy można zaoferować podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity 90x170cm, rozmiar warstwy chłonnej 82x58cm, chłonność 2000ml (wymagana 1750), chłonna pulpa celulozowa bez superabsorbentu, włóknina od strony pacjenta przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu o gramaturze 12g/m², od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 17 Poz 2.

Czy można zaoferować podkład higieniczny jednorazowego użytku, rozmiar całkowity podkładu 60x90cm, rozmiar warstwy chłonnej 82x58cm, bardzo wysoka chłonność 2500ml (wymagana min 1750ml), gramatura włókniny 12g/m, miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



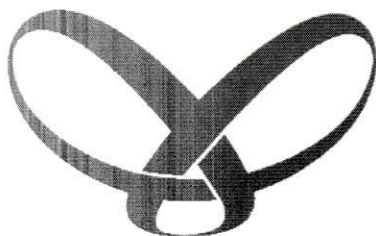

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pytania dotyczące umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający oszacował ilości przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zamierza je zrealizować w przewidywanych ilościach, jednak nie może podjąć zobowiązania określającego minimalne ilości zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i jego przeznaczenie.

Pytanie 56

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pakiet 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S, o chłonności co najmniej 1750ml wg normy ISO 11948-1, z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu, posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukołi cierpienie”



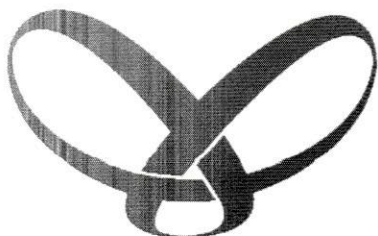

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, maksymalny obwód produktu aż 96cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, o chłonności co najmniej 2400ml wg normy ISO 11948-1, z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu, posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, maksymalny obwód produktu aż 130cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, o chłonności co najmniej 2700ml wg normy ISO 11948-1, z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu, posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, maksymalny obwód produktu aż 160cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



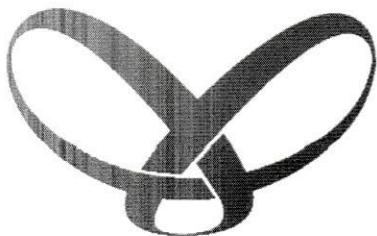

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL, o chłonności co najmniej 2750ml wg normy ISO 11948-1, z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami, jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu, posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor, maksymalny obwód produktu aż 170cm? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, o chłonności co najmniej 338g?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, o chłonności co najmniej 466g?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg, o chłonności co najmniej 532g?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



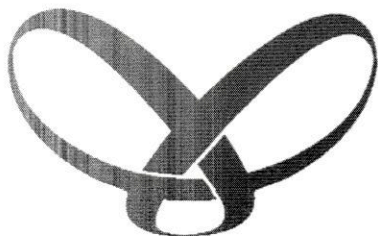

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2, pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, o chłonności co najmniej 590g?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 5 pakietu 3 podpaski pakowane w opakowania zawierające inną ilość sztuk (np. 12 sztuk) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podpasek pakowanych w opakowania zawierające maksymalnie 12 sztuk w opakowaniu, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania.

Pytanie 68

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 z pakietu 3 co pozwoli złożyć większą ilość konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje w pakiecie 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 69

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek jak dotychczas używany w Państwa Placówce wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 70

Pakiet 6, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści maski jak dotychczas używane o skuteczności filtracji $\geq 98\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 71

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maski jak dotychczas używane o skuteczności filtracji 99,88% ?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



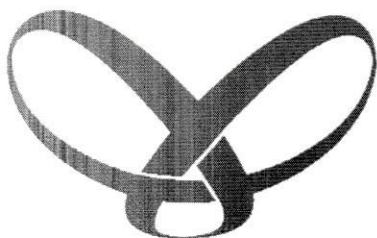

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe jak dotychczas używane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie masek 3 warstwowych. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maski o skuteczności filtracji 99,88% jak dotychczas używane ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie masek o skuteczności filtracji 99,88%. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m² jak dotychczas używany ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 75

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem jak dotychczas używany ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę jak dotychczas stosowaną w Państwa placówce w rozmiarze 12x7,5x2,3cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 77

Pakiet 9, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby gąbka zarejestrowana była jako wyrób medyczny, jak dotychczas używane u Państwa w placówce ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gąbkę nie zarejestrowaną jako wyrób medyczny. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet 9, pozycja 3



ul. Pomorska 251

☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



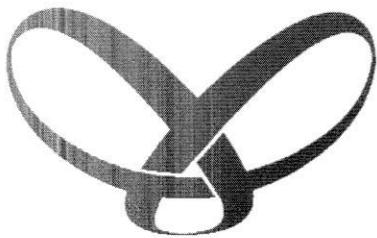

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści myjki jak dotychczas stosowaną w Państwa placówce o gramaturze 60g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet 9, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści czepki i myjki jak dotychczas stosowaną w Państwa placówce nie zarejestrowane jako kosmetyk i objęty 23% stawką VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym jak dotychczas używany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 81

Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m² jak dotychczas używane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 82

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule o obwodzie 152cm i długości 116cm jak dotychczas używane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 83

Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści klapki pakowane a'50par, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kłapek pakowanych a'50par, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet 12, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 85


Pakiet 12, pozycja 2



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie cierpienie”



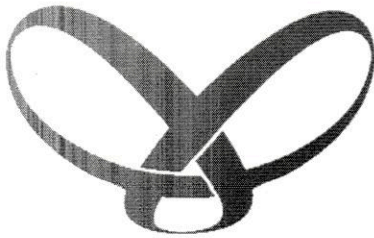

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 86

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z papieru laminowanego PE o gramaturze 23g (papier) + 14g (folia), z perforacją, co 38cm, o długości 50m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 87

Pakiet 14, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie poszwy w rozmiarze 160x210cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści poszewki na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania dostawy asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 89

Pakiet 15, pozycja 2

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli podkład chłonny w rozmiarze 60x 60cm pozostałe opisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład chłonny w rozmiarze: 60 x 60 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 90

Pakiet 15, pozycja 7, 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby gąbka zarejestrowane była, jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gąbkę nie zarejestrowaną jako wyrób medyczny. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarze XL ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”



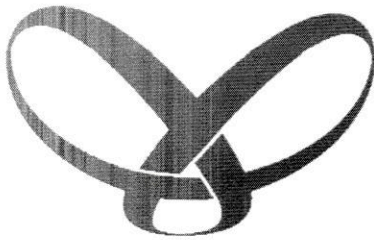

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 92

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu, Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 120g ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 93

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 100 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94

Pakiet 20, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści Kompresy wykonane ze specjalnego nietoksycznego organicznego żelu i nietoksycznej folii, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 95

czy Zamawiający dopuści:

w pakiecie 12 poz.1 i 2 rolki celulozowe z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie 96

w pakiecie 12 poz.3 rolę podfoliowaną z perforacją co 50cm, o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem ilości z 3600szt na 4680szt?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”

