

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

ZP/ 5 /2019

Łódź, dnia 25.01.2019 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytania 1

dotyczące pakietu nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu dopuści rękaw o rozmiarze 55mm x 200m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### Pytania 2

PAKIET 8

POZ.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych typu Lubrinol op 400 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

### Pytania 3

formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy – załącznik nr 2 (pakiet 18, poz.1)

Czy Zamawiający by substancja testowa naniesiona była na arkusz w sposób warstwowy oraz nierównomierny imitując tym samym realne zanieczyszczenia znajdujące się na procesowanych narzędziach w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

### Pytania 4

formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy – załącznik nr 2 (pakiet 18, poz.1)

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga testu zgodnego z obowiązującą normą dotyczącą testów do kontroli mycia mechanicznego tj. ISO/TS 15883-5?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

### Pytania 5

formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy – załącznik nr 2 (pakiet 18, poz.3)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisząc o klasie D testu? Klasyfikacja alfabetyczna testów została wycofana i nie ma na rynku testu, który mógłby spełnić tak postawiony wymóg. W związku z powyższym czy Zamawiający potwierdza, że wymaga testów opisanych w normie PN EN ISO 1140-1 o parametrach testu Typu 6? Klasa nadrukowana na teście zgodnie z wymaganiami powyższej normy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga parametrów testu Typu 6.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



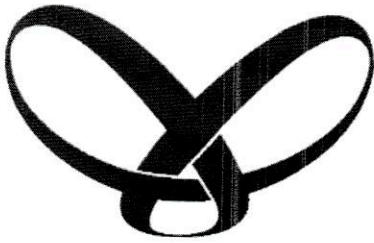

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

#### Pytania 6

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w/w asortymentu.

#### Pytania 7

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość produjących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 8

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 9

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 150-220<sup>o</sup> C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 10

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 11

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 12

Dotyczy Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki papierowo-foliowe z nadrukowanym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



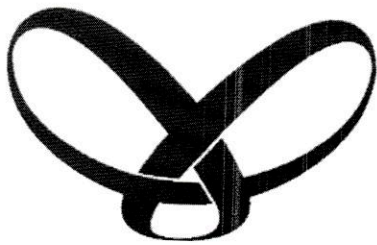

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytania 13

Pakiet 2

Poz. 6 - Czy można zaoferować rękaw papierowo-foliowy z fałdą o rozmiarze 380mmx100mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu.

#### Pytania 14

Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2

Czy należy zaoferować rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytania 15

Pakiet 5

Poz. 1 - Czy można zaoferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 100mm x 200mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

#### Pytania 16

Pakiet 5

Poz. 2 - Czy można zaoferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 130mm x 250mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

#### Pytania 17

Pakiet 5

Poz. 3 - Czy można zaoferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 90mm x 230mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

#### Pytania 18

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

#### Pytania 19

Dotyczy zapisów SIWZ:



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



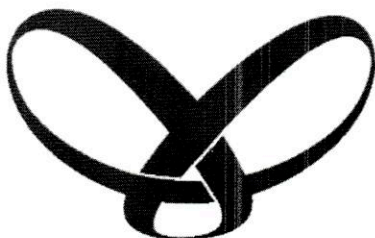

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 20**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 21**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 22**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet nr 1 Pozycje 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 23**

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 24**

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 25**

Pakiet nr 2 Pozycje 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251


☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”



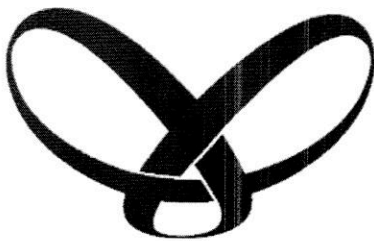

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 26**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania włókninę SMS, która wykonana jest ze specjalnej, 3-warstwowej, miękkiej włókniny nowej generacji o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> i pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Włóknina przeznaczona jest do sterylizacji parowej, plazmowej lub tlenkiem etylenu małych, średnich i dużych zestawów, w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 27**

Pakiet 16

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania testy pakowane po 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj. 10 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem „w górę”.

**Pytania 28**

Pakiet 16

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania testy pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj. 75 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 29**

Pakiet 16

Pozycja 4

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 30**

Pakiet 16

Pozycja 4

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 31**

Pakiet 16

Pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251


42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



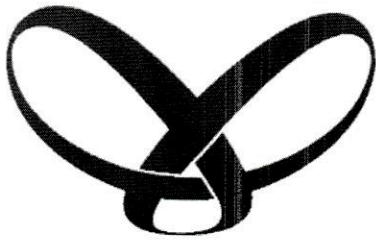

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

**Pytania 32**

Pakiet 18

Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 33**

Pakiet 18

Pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 34**

Pakiet 18

Pozycja 3

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 35**

Dotyczy Pakiet nr 3: Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewu w przedziale 120 - 150°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 36**

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 6: Czy w miejsce rękawa o szerokości 350 mm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 300 mm lub 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 37**

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja 1 i 2: Czy w miejsce testów zintegrowanych - typu 5, Zamawiający dopuści testy wyższej klasy tj. emulacyjne - typu 6. Wyższa klasa testów gwarantuje wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 38**

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja 3 i 5: Prosimy o doprecyzowanie w przypadku której wielkości opakowania 480sztuk czy 500sztuk Wykonawca ma dokonać przeliczenia?

Odpowiedź:

Przeliczenie w przypadku 480 szt.

**Pytania 39**



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”



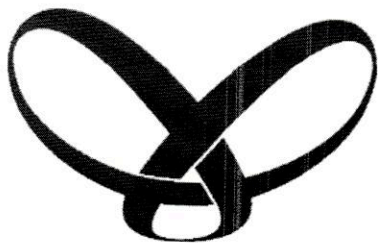

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakiet nr 16, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 40**

Dotyczy Pakiet nr 19, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

#### **Pytania 41**

Pytanie nr: 1 – dotyczy pakietu nr 20 poz: 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery do sterylizacji, transportu i przechowywania zestawów narzędziowych, wyposażonych w barierę biologiczną – zawór ciśnieniowo próżniowy umieszczony w pojedynczej pokrywie, która to w sposób nieznaczny wychodzi poza obrys wanny kontenera ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 42**

Pytanie nr: 2 – dotyczy pakietu nr 20 poz: 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery do sterylizacji, transportu i przechowywania zestawów narzędziowych, wyposażonych w barierę biologiczną – zawór ciśnieniowo próżniowy umieszczony w pojedynczej pokrywie, gdzie występuje system manualnego plombowania kontenera – który jest bardzo skuteczny i uniemożliwiający otworzenia i rozszczelnienie kontenera w sposób przypadkowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 43**

Pytanie nr: 3 – dotyczy pakietu nr 20 poz: 1,2,3,4

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery do sterylizacji, transportu i przechowywania zestawów narzędziowych, wyposażonych w barierę biologiczną – zawór ciśnieniowo próżniowy umieszczony w pojedynczej pokrywie, o następujących rozmiarach:

Poz.1 – 285x280x140mm

Poz.2 – 465x280x155mm

Poz.3 – 465x280x115mm

Poz.4 – 465x280x140mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 44**

pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 125mm x 200m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytania 45**

pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 380mm x 100m?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”



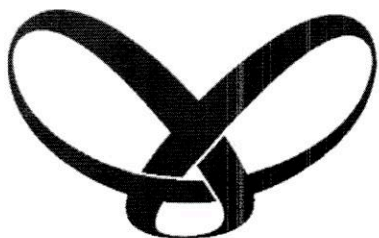

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 46**

pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 380mm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 47**

pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 380mm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania 48**

pakiet nr 15 poz. 5 i 7

Proszę o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 5 i 7 (Pokrowce ochronne, taśmy do oznaczania narzędzi typu Surg-i-band). Zwiększyłyby to konkurencyjność pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z SIWZ, w Pakiecie nr 15, dopuszcza złożenie oferty na poszczególne pozycje.

**Pytania 49**

pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza test typu Bowie-Dick Helix innej firmy niż Getinge? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami, działając z mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm.) modyfikuje Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie Szpital informuje że na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony Załącznik Nr 2 po modyfikacji (modyfikacja w zakresie Pakietu 18 poz. 3).

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

