



Łódź, dn. 2019-08-26

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 141-346729 w dniu 24/07/2019

Nr sprawy: **ZP/52/2019**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy **Pakietu nr 39**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 39 zestawy do biopsji endomiokardialnej (kleszczyki oraz koszulka biopsyjna); radioczułe (widoczne w skopii) kleszczyki jednorazowego użytku z możliwością rotacji; koszulka do biopsji teflonowa PTFE, max 7F o końcówkach: prostej oraz multipurpose dostosowanych wymiarami zarówno do dostępu udowego, jak i szyjnego; średnica zewnętrzna biopsjotomu 5.5 F (1.8 mm), 7 F (2,2 mm); dostępne dwie długości 50 cm oraz 105 cm; kleszczyki umożliwiają wykonanie biopsji zarówno prawej jak i lewej komory serca; objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F: 4,97 mm³; instrukcja w języku polskim.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.


2. Dotyczy **Pakietu nr 57**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57 biopsjotomy endokardialne długie o użytkowej długości 105 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie.

3. Dotyczy **Pakietu nr 52**

Zwracamy się o dopuszczenie w Pakiecie nr 52 cewników diagnostycznych o krzywiznach Renal Double Curve Small oraz Renal Double Curve Adult będące zapewne odpowiednikami Renal oraz Renal Left. Kształt krzywizn przedstawiamy poniżej:

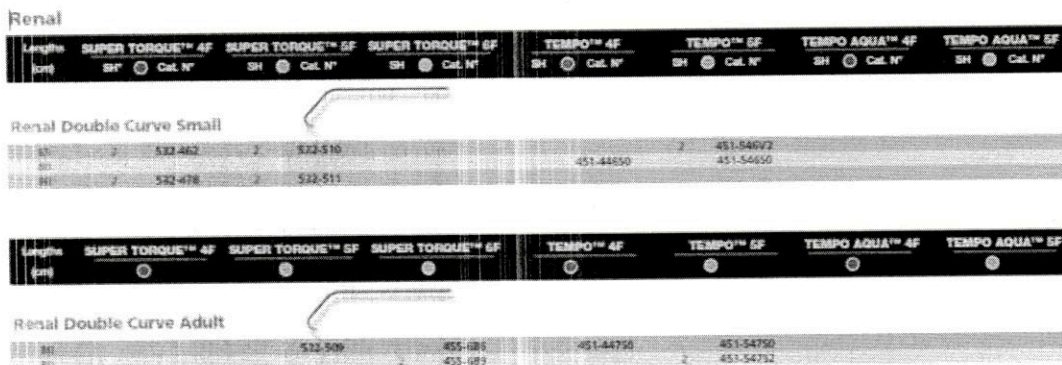

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

4. Dotyczy **Pakietu nr 53**

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny kardiostymulator jednojamowy z możliwością regulacji wyczuwania sygnałów kardiopowych i regulacji mocy impulsu stymulacji zamiast regulacji amplitudy impulsu stymulacji?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.



5. Dotyczy **Pakietu nr 30**

Z uwagi na zmiany w dostępności produktów prosimy o wykreślenie z pakietu 30 pozycji 3, 8, 15, 19.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

6. Dotyczy **Pakietu nr 42**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 42 załącznika nr 2 do siwz koszulek naczyniowych o dużych średnicach w zakresie 18-24F, bez pokrycia hydrofilnego o następujących parametrach:

- śr. 18F, długość 30cm; długość poszerzała 42cm; kompatybilne z przewodnikiem 0.038"

- śr. 20, 22, 24F, długość 25cm, długość poszerzała 41cm; kompatybilne z przewodnikiem 0.035".

Odp. Nie.

7. Dotyczy **Pakietu nr 54**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 54 załącznika nr 2 do siwz koszulek naczyniowych z zastawką hemostatyczną o dostępnych średnicach 12, 14, 16F i długości 80cm oraz średnicy 18F o długości 85cm.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

8. Dotyczy **Pakietu nr 8**

Prosimy o dopuszczenie stymulatora z możliwością wykonywania badania rezonansem magnetycznym serca 1,5T bez stref wykluczeń.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

9. Dotyczy **Pakietu nr 10**

Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

10. Dotyczy **Pakietu nr 10**

Prosimy o dopuszczenie oferty bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

11. Dotyczy **Pakietu nr 13**

Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

12. Dotyczy **Pakietu nr 22**

Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

13. Dotyczy **Pakietu nr 23**

Prosimy o dopuszczenie zestawów ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

14. Dotyczy **Pakietu nr 46, część A**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas octowy, do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, sond do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierników nosowo-gardłowych (otorynolaryngologia), sond ultradźwiękowych i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (Adeno, Noro, Polio), S (C. difficile, B. subtilis) w czasie do 15 min., w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odp. Nie.



15. Dotyczy **Pakietu nr 46, część A**

Proszę o doprecyzowanie, czy wskazana ilość 500 szt. dotyczy ilości pojedynczych chusteczek, czy 500 szt. pełnych opakowań? Jeśli dotyczy pełnych opakowań proszę o wskazanie wymaganej ilości sztuk chusteczek, by oferty mogły być porównywalne.

Odp. Dotyczy materiału pozwalającego zdezynfekować sondę 500 razy, tj. 500 zestawów po trzy chusteczki. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

16. Dotyczy **Pakietu nr 46, część A**

W przypadku informacji, iż szacunkowa ilość dotyczy pojedynczych chusteczek, z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 chusteczkę, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Jw.

17. Dotyczy **Pakietu nr 46, część A**

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odp. Zgodnie z Uwagą: Wartości i liczby w kolumnach e), f), h), l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18. Dotyczy **Pakietu nr 46, część A, kolumna l**

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego „Banku”, kto jest zobowiązany do wpłacenia kwoty.

Odp. Zamawiający dla celów księgowych/ubezpieczeniowych musi znać wartość przedłożonego depozytu/„banku”. Nikt nie jest zobowiązany do wpłacenia jego wartości.

19. Dotyczy **Pakietu nr 46, część B, Lp. 1**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniach po 50 szt.?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

20. Dotyczy **Pakietu nr 46, część B, Lp. 5**

W związku z zapisem w części B, Lp. 5 proszę o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i w/w zapisy nie dotyczą chusteczek.

Odp. Punkt 5 dotyczy przedmiotu zamówienia.

21. Dotyczy **załącznika nr 6 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie § 5 ust. 4 następującego brzmienia: „Wyżej wymieniony towar jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy **załącznika nr 6 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie § 5 ust. 5 następującego brzmienia: „Powierzony towar musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, przypadkową utratą lub uszkodzeniem zgodnie z przyjętymi u Zamawiającego zasadami, na jego koszt.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.


23. Dotyczy **załącznika nr 6 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 5 ust. 7a o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonać kontroli terminu ważności towarów znajdujących się w Banku.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Dotyczy **załącznika nr 6 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 5 ust. 6a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.”



Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Dotyczy **Pakietu nr 25 część B pkt. 16**

Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu ?

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

26. Dotyczy **UMOWY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 5 ust 12.2 umowy:

z: „Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.”

na: „Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania przedmiotem dzierżawy, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy.”

Urządzenie, które będzie podlegało dzierżawie jest własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nim.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

27. Dotyczy **UMOWY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu możliwych zmian umowy określonych w § 9 ust. 3 o zapisy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, po cenie zaoferowanej w ofercie?

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 39 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

PAKIET NR 39- Zestaw do biopsji endomiokardialnej	
CZĘŚĆ A	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Zestaw do biopsji endomiokardialnej (kleszczyki oraz koszulka biopsyjna) Zamawiający dopuszcza zestawy do biopsji endomiokardialnej (kleszczyki oraz koszulka biopsyjna); radioczułe (widoczne w skopii) kleszczyki jednorazowego użytku z możliwością rotacji; koszulka do biopsji teflonowa PTFE, max 7F o końcówkach: prostej oraz multipurpose dostosowanych wymiarami zarówno do dostępu udowego, jak i szyjnego; średnica zewnętrzna biopotomu 5.5 F (1.8 mm), 7 F (2,2 mm); dostępne dwie długości 50 cm oraz 105 cm; kleszczyki umożliwiają wykonanie biopsji zarówno prawej jak i lewej komory serca; objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F: 4,97 mm³; instrukcja w języku polskim.

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 52 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

PAKIET NR 52- Elektrody wewnątrzsercowe do stymulacji czasowej	
CZĘŚĆ A	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Elektrody wewnątrzsercowe do stymulacji czasowej Zamawiający dopuszcza cewniki diagnostyczne o krzywiznach Renal Double Curve Small oraz Renal Double Curve Adult, zgodnych z odpowiedzią nr 3 - Wyjaśnienia treści SIWZ.

1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 53 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:



PAKIET NR 53- Stymulatory do stymulacji czasowej	
CZĘŚĆ A	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Stymulatory do stymulacji czasowej Zamawiający dopuszcza zewnętrzny kardiostymulator jednojamowy z możliwością regulacji wyczuwania sygnałów kardiologicznych i regulacji mocy impulsu stymulacji zamiast regulacji amplitudy impulsu stymulacji.

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 30, poprzez wykreślenie pozycji 3, 8, 15, 19, po zmianie uzyskuje brzmienie:

PAKIET NR 30- ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
	ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
1.	Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016" do 0,032"
2.	Koszulki poszerzające Byrd polipropylenowe (pary składające się z koszulki zewnętrznej i wewnętrznej o długości 33/38cm oraz 41/46cm)
3.	Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod. Średnice koszulek wewnętrznych 9.0-11.0F Długość zestawu 13,6 cm
4.	Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod. Średnice koszulek wewnętrznych w zakresie 9-13F
5.	Koszulka stabilizująca
6.	Nożyczki do obcinania elektrod
7.	Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową
8.	Poszerzacz do wewnętrznej spirali elektrody
9.	Mandryn używany do udrażniania kanału elektrody
10.	Chwytek atraumatyczny
11.	Mandryn -przeznaczony do usuwania elektrod bez światła
12.	Pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego śred. Introducera 4 -6 F wielkość pętli 5mm -30mm
13.	One -Tie zwój ściskający pakowany po 5 szt. - podano cenę za 1 szt.)
14.	Introducery naczyniowe o długości powyżej 20cm i średnicy 7-12F
15.	Introducery naczyniowe o długości powyżej 20cm i średnicy 7-12F

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 54 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

PAKIET NR 54- Śluz naczyniowe o dużych przekrojach	
CZĘŚĆ A	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Śluz naczyniowe o dużych przekrojach Zamawiający dopuszcza koszulki naczyniowe z zastawką hemostatyczną o dostępnych średnicach 12, 14, 16F i długości 80cm oraz średnicy 18F o długości 85cm.


- 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 10, poprzez dopisanie Uwaga, tiret 1,2 o treści:

UWAGA:

- ▶ **Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.**
- ▶ **Zamawiający dopuszcza ofertę bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.**

- 1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 13, poprzez dopisanie Uwaga, tiret 1, o treści:

UWAGA:



- Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
- 1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 22 , poprzez dopisanie Uwaga, tiret 1, o treści:
- UWAGA:**
- Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
- 1.9. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 23 , poprzez dopisanie Uwaga, tiret 1, o treści:
- UWAGA:**
- Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
- 1.10. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 25 , poprzez dopisanie Uwaga, tiret 1, o treści:
- UWAGA:**
- Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu.
- 1.11. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 46 poz. 1, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

PAKIET NR 46- Zestaw chusteczek do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej

CZĘŚĆ A

Lp.	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy	Jednostka miary
a	b	c	d
1.	Zestaw chusteczek do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej	500	zestaw

CZĘŚĆ B


Lp.	Wymagane parametry graniczne
1.	Zestaw= 3 chusteczki walidowane do dezynfekcji instrumentów ultradźwiękowych; opakowania max. 50 szt.
2.	Minimalny czas kontaktu w celu uzyskania dezynfekcji 30s.
3.	Pełne spektrum dezynfekcji łącznie z działaniem sporobójczym
4.	Zestaw spełniający normy dla tego typu technologii
5.	Proces trój etapowy: trójzwiązkowe mycie wstępne, dezynfekcja w tym sporobójcza, płukanie końcowe;

- 1.12. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM w zakresie pozycji Pakiet 30 oraz łącznej wartości wadium:

„1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości **286 806,00 PLN** (słownie: **dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześć złotych 00/100**) dla całości zamówienia lub w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.

PAKIET NR 30- ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH	12 996,00 zł
---	--------------

- 1.13. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 6 Wzór umowy § 5 ust. 12 poprzez modyfikację zapisu pkt. 12.2 i dopisanie pkt. 12.3 o brzmieniu:
- „12.2. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu dzierżawy i że przedmiot ten nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich.*
- 12.3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania przedmiotem dzierżawy, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy oraz, że na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży potwierdzające dokumenty.*”
- 1.14. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 3 poprzez dopisanie pkt. g) o brzmieniu:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

„g) w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta bądź zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w umowie.”

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2019-09-11**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2019-11-09**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Miazek